


(B) ChemStationメソッド&コントロール

LC6. DAD の Ref 波長を変更した所、"パラメーターミスマッチ"と出てしまいます。

[メソッド]→[メソッド全体の編集]から、データ解析にチェックを入れてOKをクリックした後、**シグナル詳細**で検量線で使用した波長をメソッドに追加して下さい。

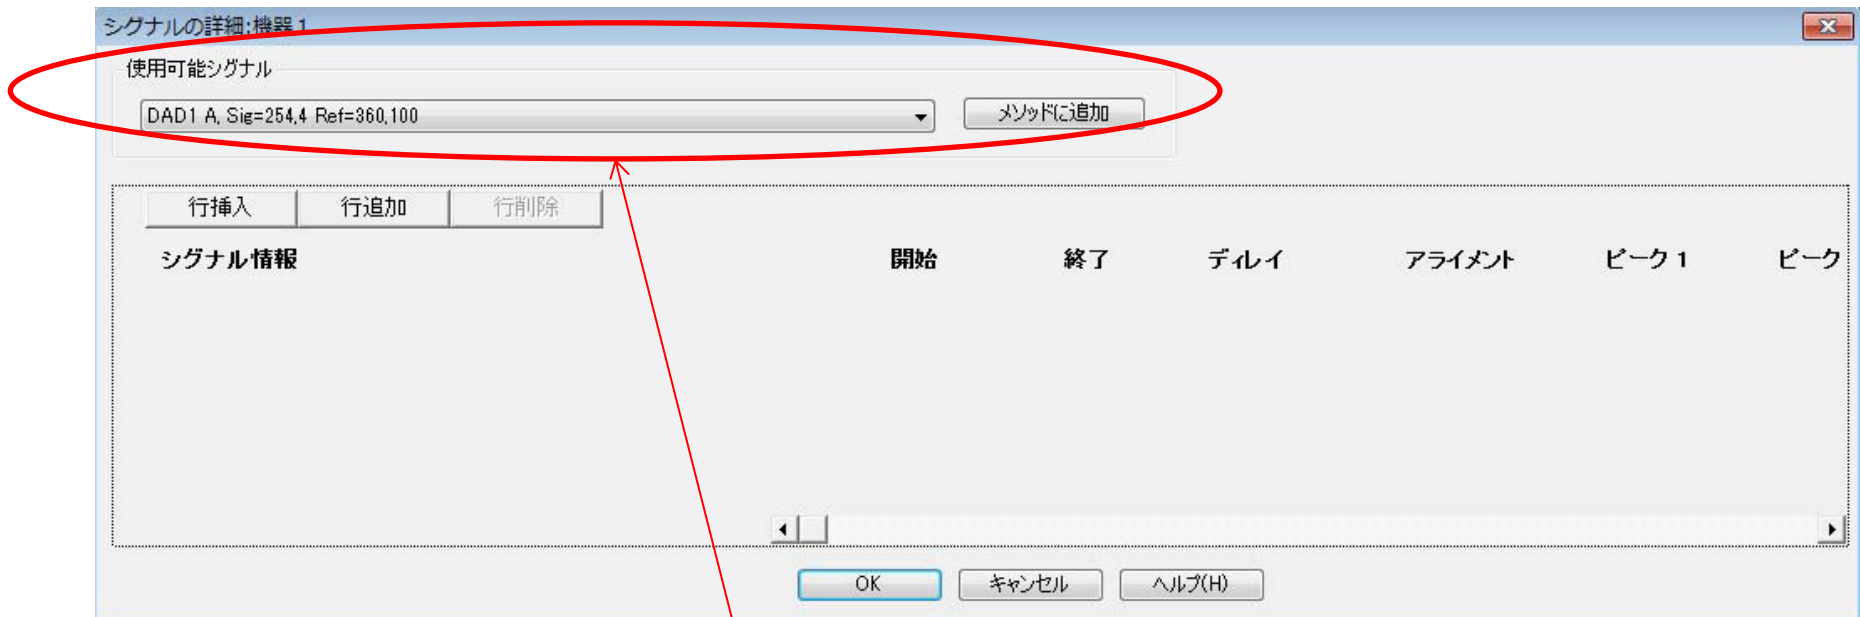

検量線で使用した波長をプルダウンから選んで、メソッドに追加をクリック。