


(D) ChemStation レポートレイアウト

共通8. レポートレイアウトで、クラシックレポートを作成したい。

機器コンフィグレーション画面での変更が必要になります。OpenLABコントロールパネルを起動し、機器メニューで該当装置を選択してください。画面右上の「機器コンフィグレーション」アイコンをクリックします。ポップアップ画面の機器コンフィグレーションウィンドウ右上に表示されている、「インテリジェントレポートを有効」チェックを外してください。



ここをクリック

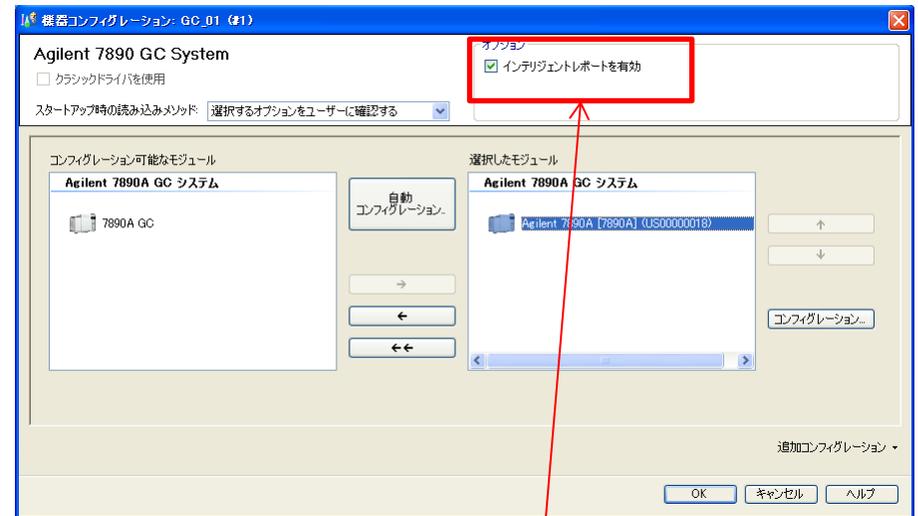

このチェックを外す