


フィラメント切り替え方法(Mass Hunter Software)

機器コントロール画面から、マニュアルチューニング画面に切り替えます。

①「表示」>「チューニングと真空制御」を選択してください。


②次に、パラメータ>「マニュアルチューニング」を選択してください。

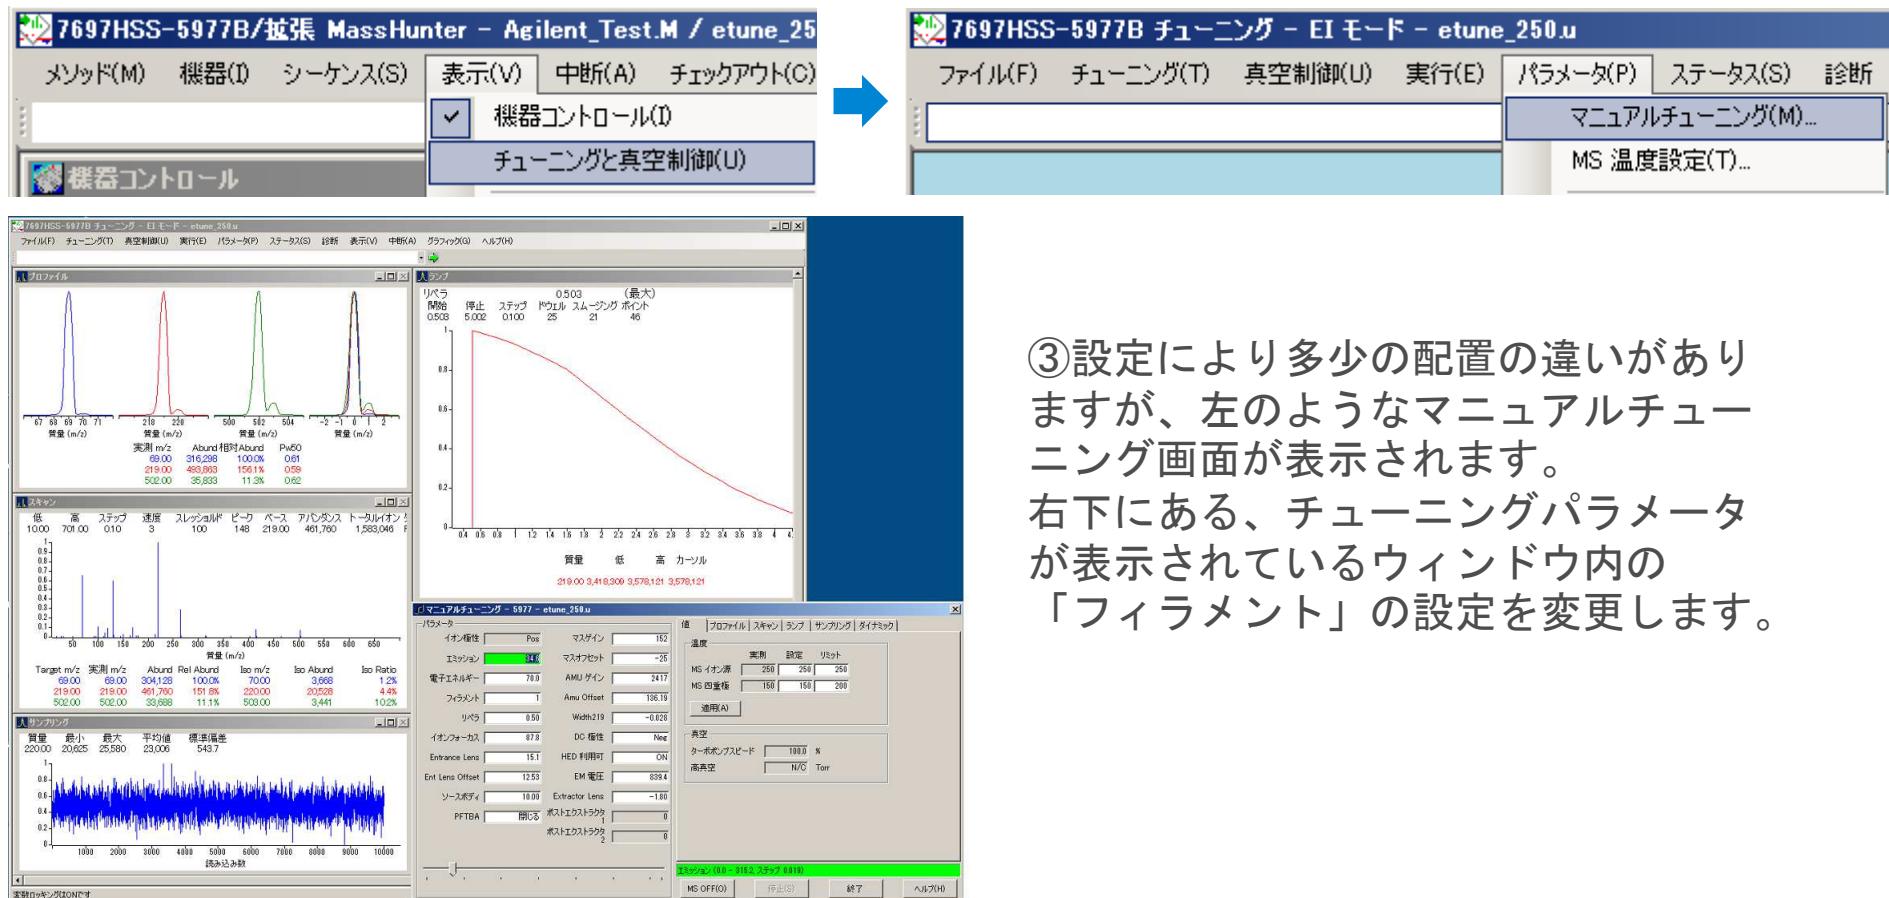

③設定により多少の配置の違いがありますが、左のようなマニュアルチューニング画面が表示されます。
右下にある、チューニングパラメータが表示されているウィンドウ内の
「フィラメント」の設定を変更します。


フィラメント切り替え方法(Mass Hunter Software)

④「フィラメント」のボックスにカーソルを移動して、ダブルクリックするとフィラメントが1⇒2と切り替わります。

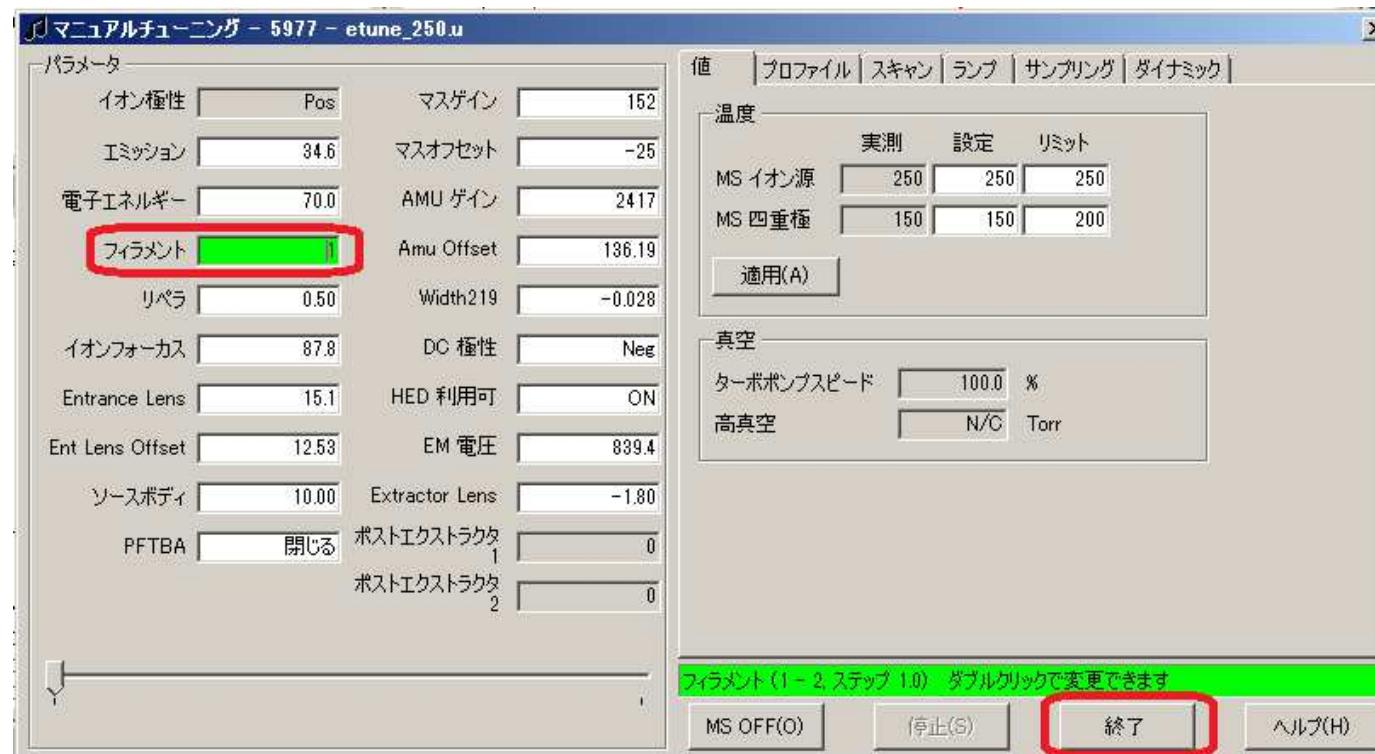

⑤フィラメントを切り替えたのち、画面右下にある「終了」を押します。

フィラメント切り替え方法(Mass Hunter Software)

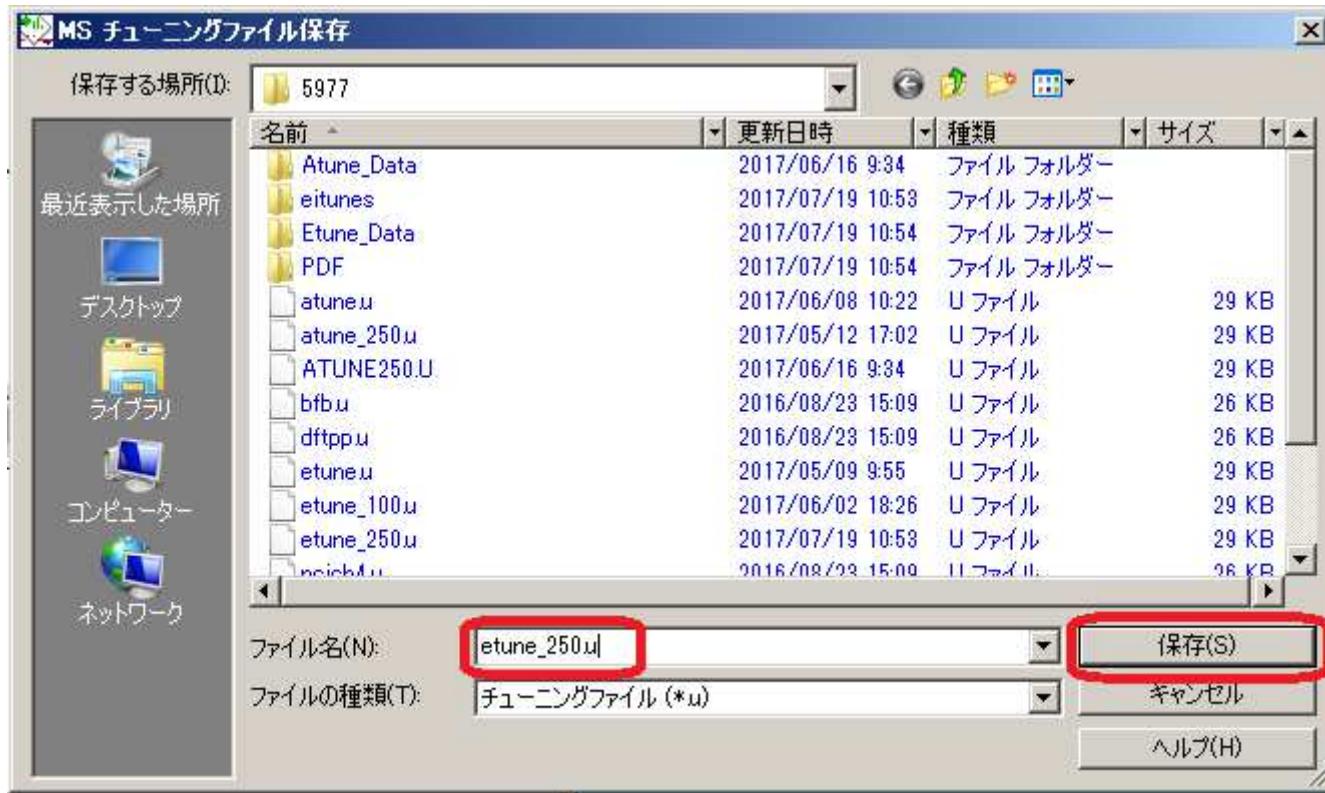

- ⑥次に、「MSチューニングファイル保存」のウィンドウが表示されますので、ファイル名に現在ご使用のチューニングファイルが表示されていることを確認して、「保存」を押します。
- ⑦保存後に、再度チューニングを実施してください。